MECTRON PROPHYLAXE
GLÄNZENDE RESULTATE DANK PERFEKTER ABSTIMMUNG

MASSGESCHNEIDERTE LÖSUNGEN PASSEND

PROPHYLAXIS POWDER SOFT^{L}
PROPHYLAXIS POWDER SOFT^{M}

Entfernt sanft und effektiv supragingivalen Biofilm und Verfärbungen von der Zahnoberfläche

INDIKATIONEN:

- Entfernen von extrinsischen Verfärbungen durch Tabak, Wein, Tee und Farbstoffe
- Reinigen von Fissuren und Kavitäten
- Behandlung von kieferorthopädischen Patienten

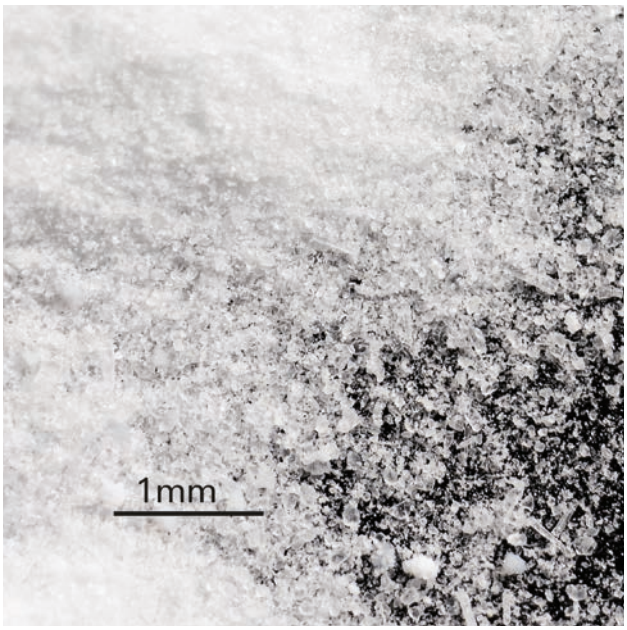

Form der Natriumbikarbonat-Partikel vergrößert auf 1 mm

PROPHYLAXIS POWDER SOFT^{L} + SOFT^{M}

- Basierend auf Natriumbikarbonat
- Durchschnittliche Partikelgröße 55 µm
- Erhältlich in zwei Geschmacksrichtungen: Lemon und Minze
- Verpackung: 4 Flaschen mit je 250 g
- Artikel Nr. 03140030 - SOFT^{L}

  Artikel Nr. 03140026 - SOFT^{M}

FÜR DIE BEDÜRFNISSE IHRER PATIENTEN

PROPHYLAXIS POWDER SENSITIVE+ – GLYCINE POWDER

Entfernt schonend supra- und subgingivalen Biofilm

INDIKATIONEN:

- Sanftes Entfernen von Verfärbungen
- Detoxifikation parodontaler Taschen
- Parodontale Erhaltungstherapie
- Implantpflege und behandeln von Peri-Implantitis
- Reinigen kieferorthopädischer Brackets
- Schonendes Reinigen restaurativer Materialien
- Minimal invasiv auf freiliegenden Zahnhälsen und Dentin
- Reduziert Belastung mit kolonie-bildenden Bakterien
- Kann erfolgreich zur Behandlung aller Arten von Patienten eingesetzt werden

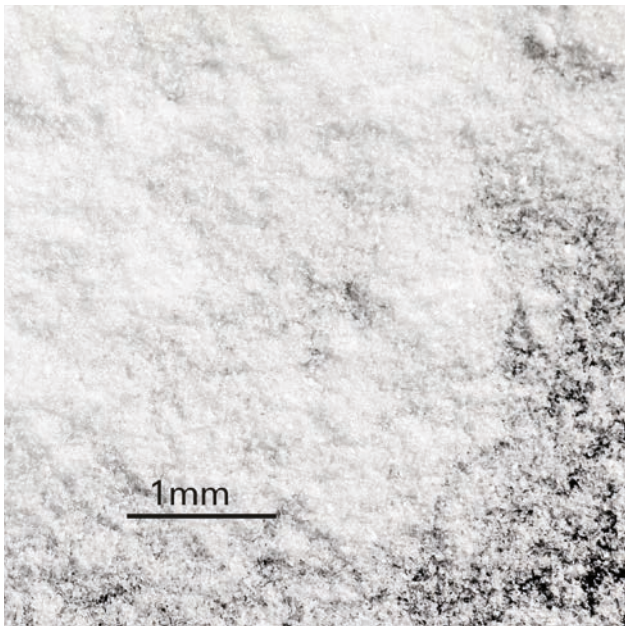

Form der feinen, minimal invasiven Glyzin-Partikel vergrößert auf 1 mm

PROPHYLAXIS POWDER SENSITIVE+ – GLYCINE POWDER

- Basierend auf Glyzin
- Durchschnittliche Partikelgröße 25 µm
- Süßlicher Geschmack
- Verpackung: 2 Flaschen mit je 160 g
- Artikel Nr. 03140021

DIE EVOLUTION DER PROPHYLAXE

STARJET

turbinenadaptiertes Pulverstrahlgerät für die supra- und subgingivale Anwendung

COMBI *touch*

Ultraschalleinheit und Pulverstrahlgerät in einem

INDIKATIONEN	SOFT[L] SOFT[M]	SENSI-TIVE[+]	INDIKATIONEN	SOFT[L] SOFT[M]	SENSI-TIVE[+]
Entfernung von supragingivalem Biofilm	●	●	Behandlung der Peri-Implantitis	○	●
Entfernung von extrinsischen Verfärbungen	●	○	Reinigen von Brackets	●	●
Entfernung von subgingivalem Biofilm	○	●	Reinigen restaurativer Materialien	○	●
Detoxifikation von parodontalen Taschen	○	●	Pflege von Füllungen	○	●
Pflege von Implantatoberflächen	○	●			

Referenzen:

- Bühler, Julia & Amato, Mauro & Weiger, Roland & Walter, Clemens. (2015). *A systematic review on the effects of air polishing devices on oral tissues.* International Journal of Dental Hygiene. 14. 10.1111/idh.12120.
- Hongsathavij, Rosalin & Kuphasuk, Yosvimol & Rattanasuwan, Kanyawat. (2017). *Clinical comparison of the stain removal efficacy of two air polishing powders.* European Journal of Dentistry. 11. 370-375. 10.4103/ejd.ejd_152_17.
- Poormoradi, Banafsheh & Tamasoki, Shahrzad & Shahbazi, Armaghan & Hooshyarfard, Amirarsalan & Vahdatinia, Farshid & Behgozin, Faeze & Tapak, Leili. (2018). *The comparison of two professional prophylaxis systems in plaque removal and debonding of orthodontic brackets.* Journal of Indian Society of Periodontology. 22. 414. 10.4103/jisp.jisp_387_17.

Vertrieb durch: Bien-Air Dental SA,
Länggasse 60, 2500 Bienne 6, Tel +41 (0)32 344 64 25,
info@mectron.ch, www.mectron.ch

PROPHYLAXIS POWDER SOFT[L] und SOFT[M] sind registriert und hergestellt von SPEIKO - Dr. Speier GmbH, Walther-Rathenau-Str. 59, 33602 Bielefeld, Germany
PROPHYLAXIS POWDER SENSITIVE[+] ist registriert und hergestellt von PRISMAN GmbH, Otto-Hahn-Ring 6-18, 64653 Lorsch, Germany

© Copyright Mectron S.p.A., Carasco, Italien
Alle Rechte vorbehalten. Text, Bilder und Grafiken der mectron-Broschüren unterliegen dem Schutz des Urheberrechts und anderer Schutzgesetze. Ohne schriftliche Zustimmung dürfen die Inhalte nicht zu kommerziellen Zwecken kopiert, verbreitet, verändert oder Dritten zugänglich gemacht werden.

mectron
medical technology

© mectron DEFLY0092DECH-2308